

SECURISATION VOIES D'ADMINISTRATION

Journée régionale sécurisation et vigilance des DM

04 juin 2026

Adeline Cartillier IADE HNOV
Laura Menard Pharmacien Croix Rousse
Fabienne Chatillon Pharmacien HNOV


Cadre réglementaire

Contexte

- ❖ Nombreux cas d'**erreurs de connexions** avec la connectique universelle Luer.
 - ❖ Injections de molécules destinées à la voie neuraxiales par voie IV, et inversement
 - ❖ Administration de nutrition entérale par voie IV
- ❖ **Never-Event (ANSM)** : « Injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse »
- ❖ **Moyen de prévention de ces erreurs par sécurisation des connectiques via des systèmes dédiés aux différentes voies d'abord:**
Norme ISO 80369
 - ❖ Principe: **Incompatibilité physique des connectiques pour éviter les erreurs**
 - ❖ Remise en cause de la connectique Luer
 - ❖ Sécurisation de la voie entérale, puis neuraxiale et périneurale

Structure de la norme ISO-80369

- Subdivision en plusieurs sous-parties

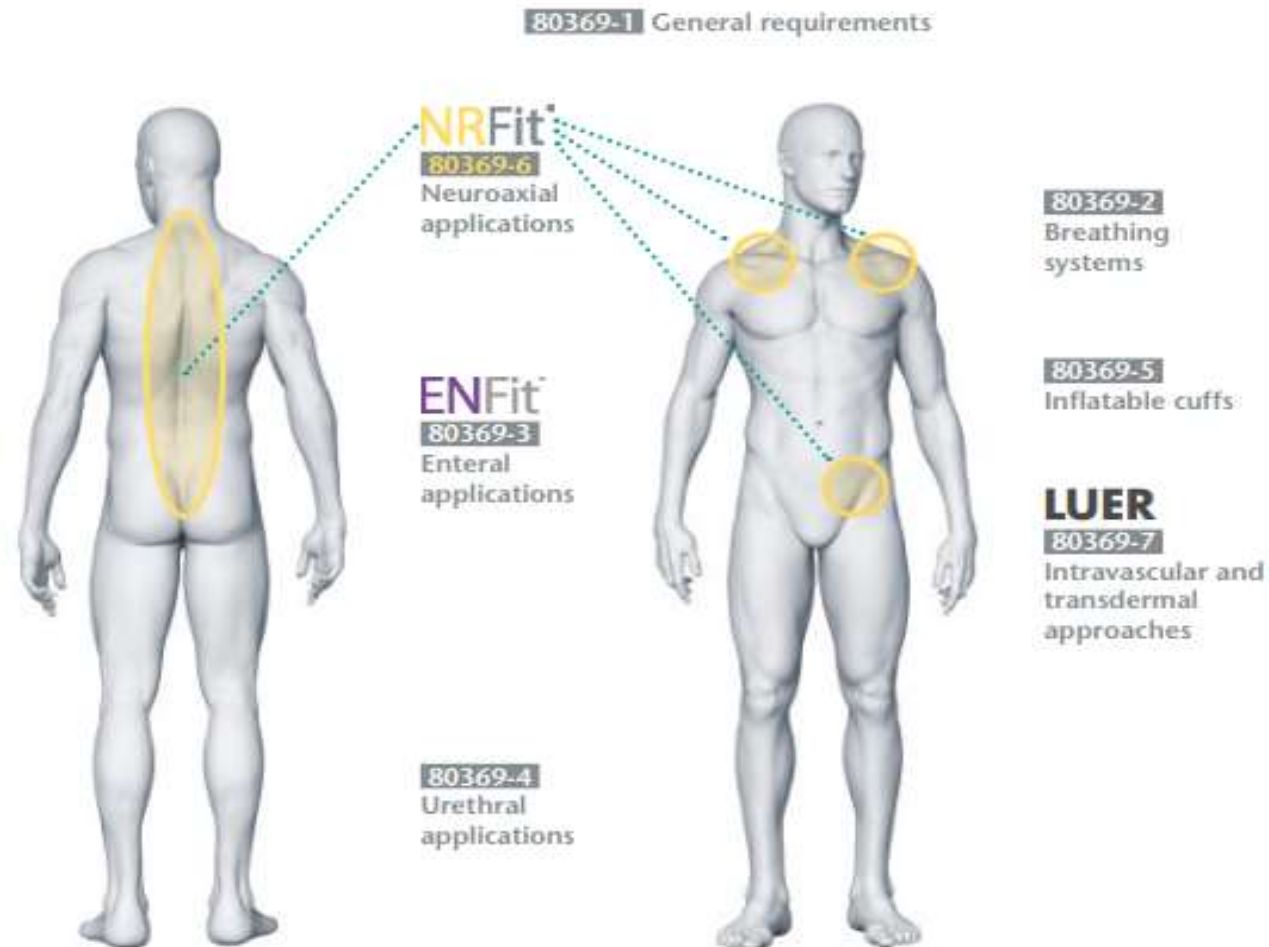

ENFit[®]
NRFit[®]
LUER

Description de la connectique ENFit®

- Connectique spécifique de **la voie entérale**




- Géométrie incompatible avec les connecteurs Luer.
- Réduction du risque d'administration accidentelle d'aliments ou de médicaments par voie intraveineuse.
- Utilisation sur les sondes gastriques, jéjunales, tubulaires et seringues de nutrition entérale
- Couleur **violette** pour une meilleur identification

Description de la connectique NRFit®

❖ Connecteur NRFit :

- ❖ **Diamètre plus étroit (20%)** que le Luer standard
- ❖ **Longueur plus grande** que le Luer standard
- ❖ **Couleur jaune** pour une meilleure identification

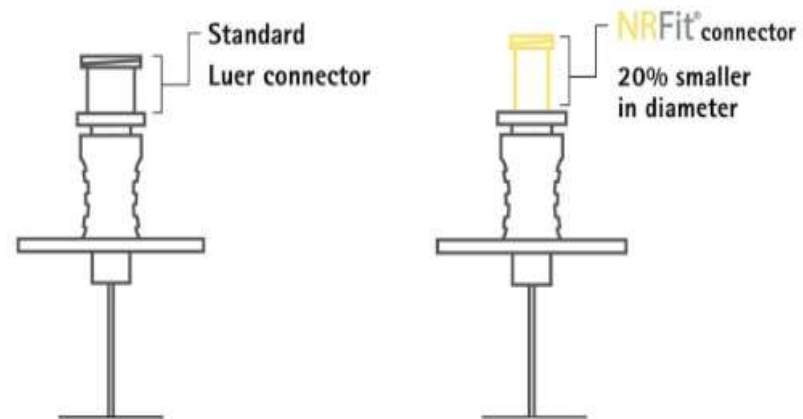

Cas pratique

Vous devez implémenter dans votre
établissement ces dispositifs de
sécurisation

Comment procédez vous ?

Proposition d'une trame de réflexion

Choix du périmètre

Définition d'une stratégie

Anticipation des freins et risques

Leviers et pré requis

Autres ?

Retour d'expérience HNO Villefranche

- Groupe de travail : anesthésiste, IADE, Etudiante PUI, pharmacien
- Stratégie choix du déploiement évolutif : à partir d'un acte de péridurale une sécurisation globale a été finalement optée, grâce au bilan des actes recensés en anesthésie et ailleurs avec tous les autres consommateurs d'aiguilles de PL identifiés à partir des consommations des DMS
- Le NR fit évident connu : actes d'anesthésie, blood patch les injections intrathécales en onco hémato
- Le Nr fit : ailleurs? actes découverts : mesure de pression en neuro, chir du rachis, BIF aux urgences
- Prévision des équivalences de DMS Nr fit pour tous les actes à sécuriser
- Le Nr fit oui mais pas que 😊 : Usages détournés des aiguilles à PL : alternatives à proposer en non NR Fit

- Déroulement PUI :
 - Anticipation des stocks 3 mois et plus pour tubulure pompe! Liée à l'absence de réponse de plus de 6 mois sur la disponibilité
 - Liste de établissements secours
 - Fin de semaine précédant le changement en services : catalogues des dms modifiés et stock de la Pui mis en place des ref NR fit et de substitution
 - J1 : toute l'anesthésie et dms bloc
 - J2 : urgences radiologie
 - J3 : neuro onco hémato, réa
 - J4 : URCC
- Choix du déploiement en one shot par service avec accompagnement de chaque service affiche dédiée rdv individuel

Retour d'expérience Hôpital de la Croix- Rousse HCL

- Groupe de travail pluridisciplinaire: anesthésistes, IADES, direction des achats, pharmacie
- Identification du périmètre
- Extraction des consommations des DM concernés
- Identification de chaque geste et tableau d'équivalence des DM NRFit (penser aux seringues, bouchons, trocarts...)
- Déploiement progressif par service, en 1 jour :
 - Bloc général
 - Obstétrique
 - Gynécologie

Point de vigilance:

- nécessité d'anticiper les commandes auprès des fournisseurs pour s'assurer de la disponibilité en stock (2-3 mois de stock)
 - Vérification des zones de stockage (place pour ajouter les DMS supplémentaires)
 - Usages off-label (aiguilles PL+++)
- Communication importante:
 - Par mail
 - Réunions de cadres et cellule locale qualité
 - Formation avec les fournisseurs
 - Mise à disposition d'échantillons pour les équipes IADES afin de se familiariser
 - Affiches explicatives au déploiement

LES ESSENTIELS

- OBJECTIF : sécurisation administration attention à la temporalité...
- DEFINITION
 - Périmètre : quels actes ou / et quels services selon moyens humains disponibles, objectif de la direction
 - Stratégie avec création, comité de pilotage : tous les représentants des utilisateurs : praticien cadres, personnel référent technique
- DEROULEMENT
 - Audit de pratiques indispensables avec tous les utilisateurs ET sensibilisation à la sécurisation
 - Equivalence des pratiques, inventaire du matériel Nr fit ou non Nr fit nécessaires
 - Démarche d'achat avec fournisseurs +/- prêts et disponibilité des stocks 😊
 - Accompagnement au changement supports, temps de formation au plus prêt du déploiement puis accompagnement